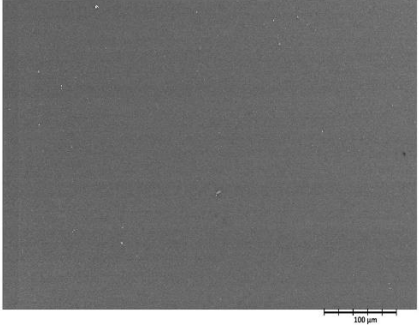
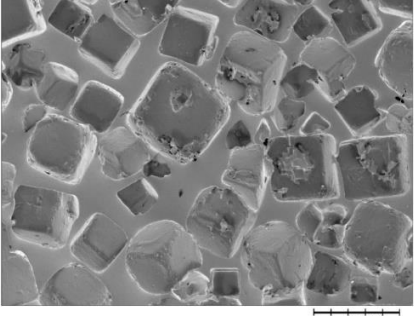
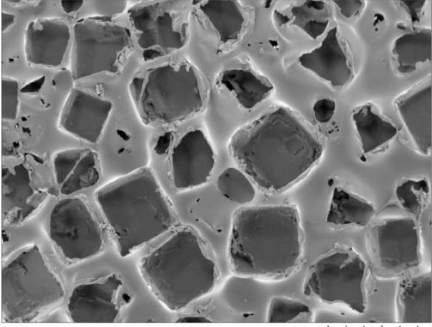
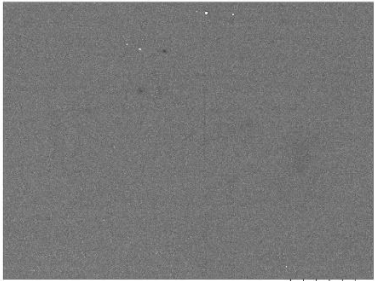
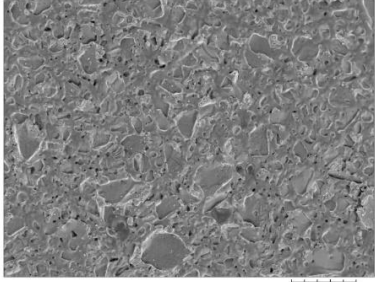
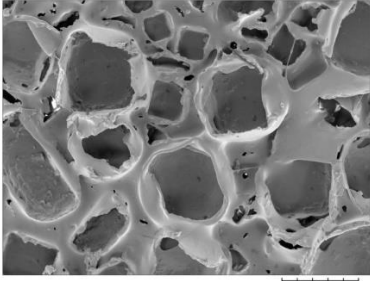

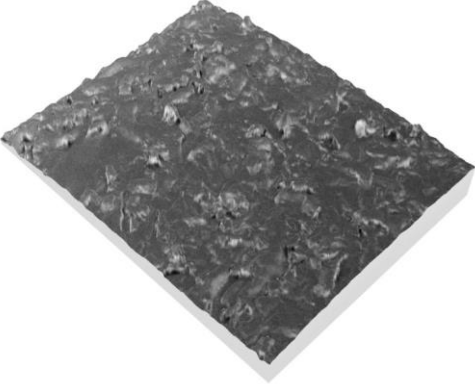
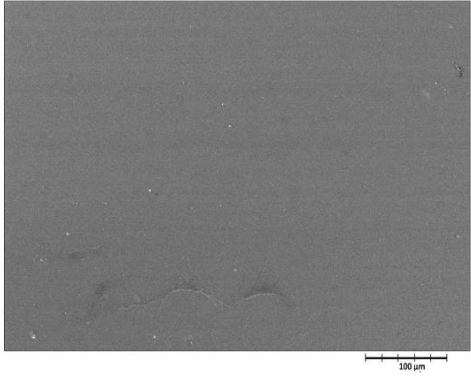
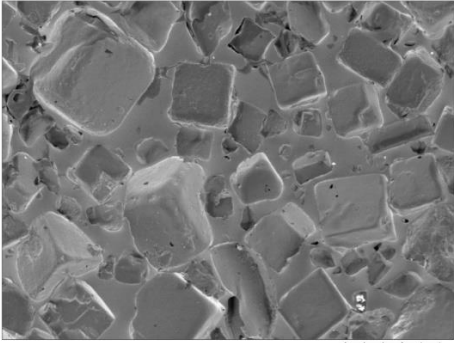
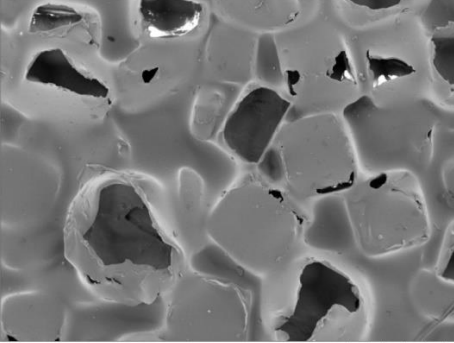
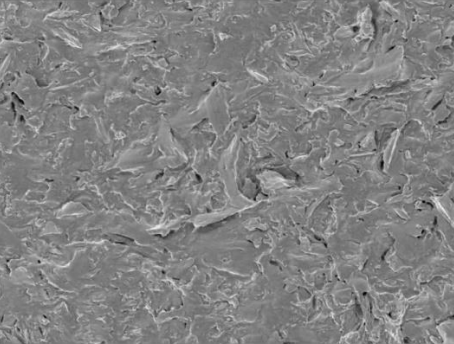


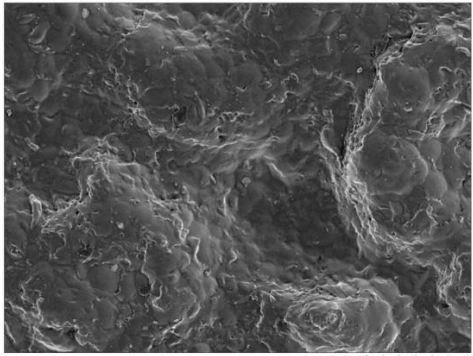
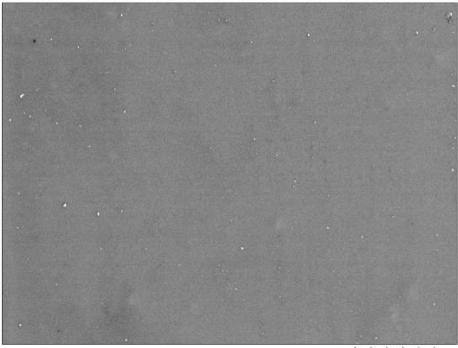
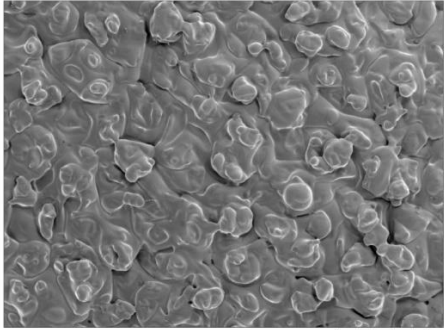
DESCRIPTION DES TEXTURATIONS DES IMPLANTS MAMMAIRES mis sur le marché en France depuis 2016 – mise à jour décembre 2022

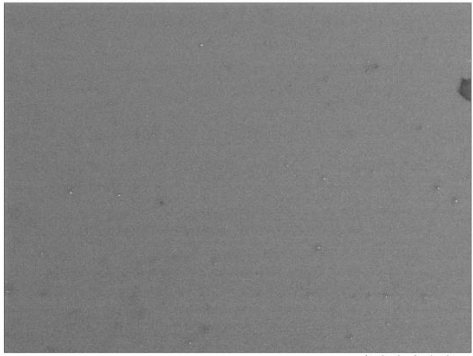
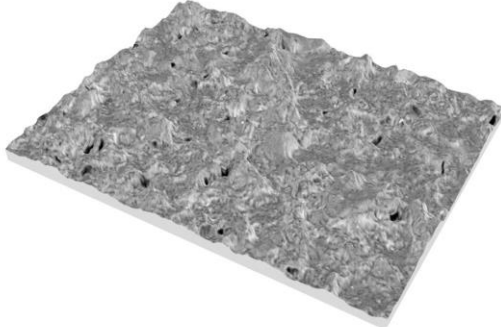
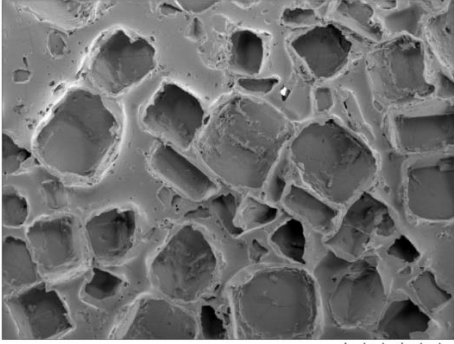
Fabricant	Exemple de Modèle / ref (non exhaustif)	Texture commerciale (revendication fabricant, par ex. selon la norme ISO 14607 : 2018)	Photo de microscopie électronique	Texture selon le référentiel IEM	Réf / source pour la classification IEM	Mise sur le marché en France
ALLERGAN	Exemple : N-SSF-XXX N-SRM-XXX	Lisse		Lisse	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 20 mai 2021
ALLERGAN	Exemple : CLP-XXX CMP-XXX RMP-XXX	Microcell		Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 16 novembre 2018
ALLERGAN	Exemple : N-TRFXXX N-TSFXXX N-27-FMXXX-XXX N-ST-MFXXX-XXX	Biocell		Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 16 novembre 2018

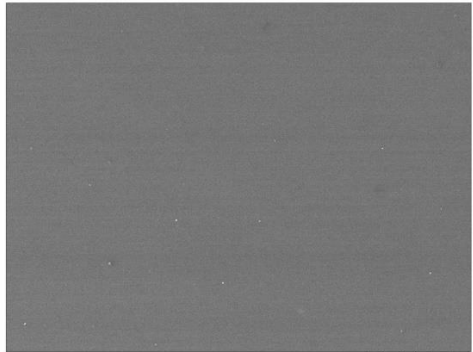
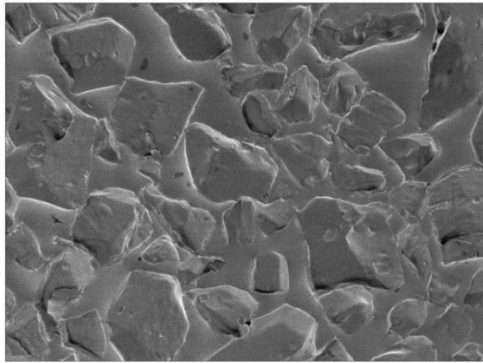
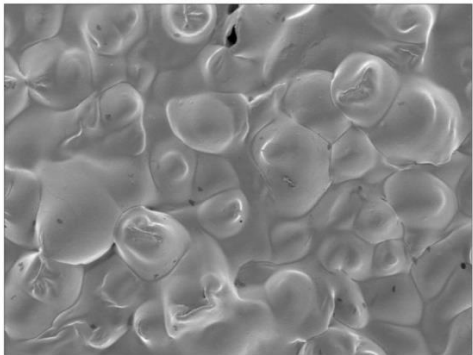
ARION	GS-XXX-NNN-L	Lisse	 x200	Lisse	Rapport IEM de 2018	Oui
ARION	GS-XXX-NNN-MT	Lisse	 x200	Microtexture	Rapport IEM de 2018	Oui
ARION	GS-XXX-NNN-T	Texturée	 x50	Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019

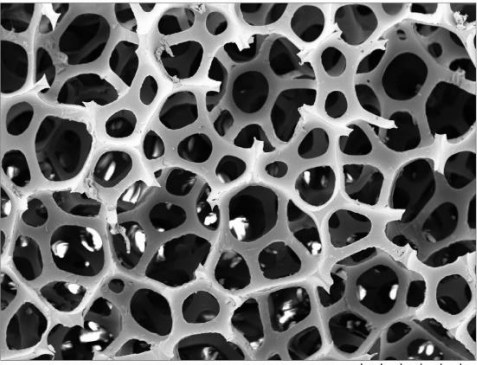

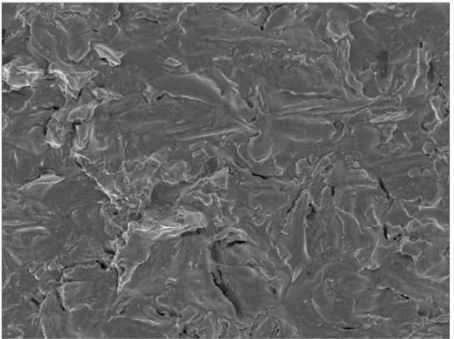
<p>EUROMI BIOSCIENCES</p>	<p>CEREFORM RMSxxx RHSxxx RMSxxx</p>	<p>Lisse</p>		<p>Lisse</p>	<p>Contrôle lors de la notification ANSM en 2021</p>	<p>oui</p>
<p>EUROMI BIOSCIENCES</p>	<p>CEREFORM RHMVxxx RVHMVxxx RMMVxxx</p>	<p>Texturée</p>		<p>Microtexture</p>	<p>Contrôle lors de la notification ANSM en 2021</p>	<p>oui</p>
<p>EUROSILICONE</p>	<p>Paragel ES 26X ES 28X</p>	<p>Lisse</p>	 <p>X200</p>	<p>Lisse</p>	<p>Rapport IEM de 2018</p>	<p>Oui</p>

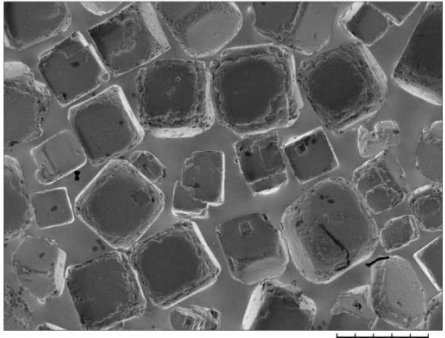
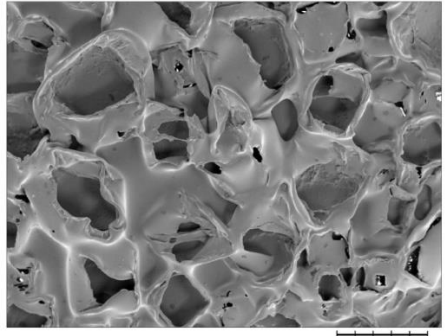
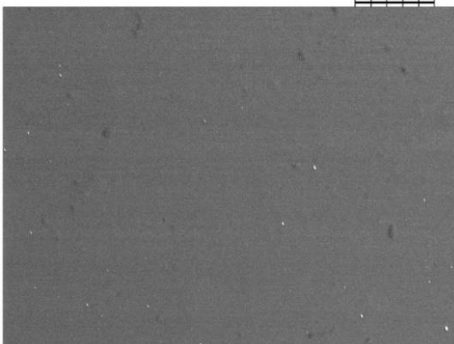
EUROSILICONE	Cristalline Paragel ES 80X ES 81X	Microtexture	 <p style="text-align: center;">X50</p>	Macrotexture	Rapport IEM de 2018	Oui
EUROSILICONE	Matrix TM-FXX TM-MXX TM-LXX	Texturé (avant 2019) Macrotexturé (depuis 2019)*	 <p style="text-align: center;">X50</p>	Macrotexture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019
ESTABLISH MENT LABS	Silksurface	Lisse	 <p style="text-align: center;">X200</p>	Microtexture	Rapport IEM de 2018	Oui

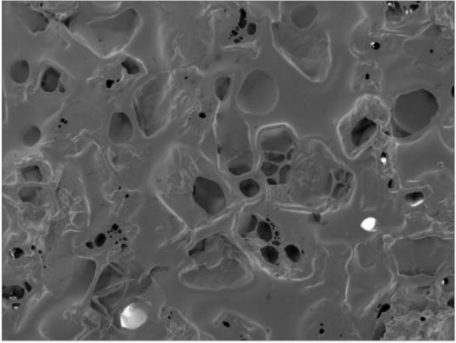
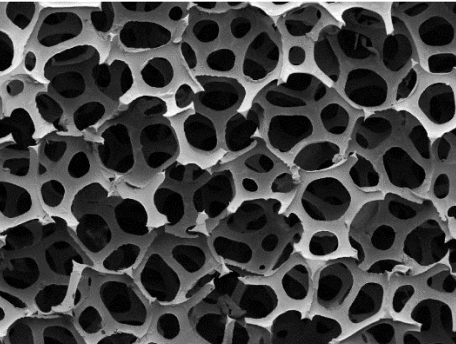
ESTABLISH MENT LABS	Velvet	Microtexture	 <p data-bbox="1058 570 1121 594">X200</p>	Microtexture	Rapport IEM de 2018	Non
MENTOR- PEROUSE	PM Style	Lisse	 <p data-bbox="1058 967 1121 992">x200</p>	Lisse	Rapport IEM de 2018	Oui
MENTOR- PEROUSE	Siltex	Texturée	 <p data-bbox="1291 1323 1339 1346">x50</p>	Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Oui

NAGOR	IMPLEO® IMP-XXX	Smooth	 X200	Lisse	Rapport IEM de 2018	Oui
NAGOR	PERLE® SOR-XXX	Lisse opaque		Microtexture	Contrôle lors de la notification ANSM en 2020	Oui
NAGOR	Exemple : GFX-XXX IMPLEO-XXX COGEL XFx XMx XLx	Texturé	 X50	Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019

POLYTECH	Smooth SMO	Lisse	 <p>X200</p>	Lisse	Rapport IEM de 2018	Oui
POLYTECH	MESMO	Microtexture	 <p>X50</p>	Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Oui
POLYTECH	POLYTXT	Macrotecture (avant 2019) Microtexture (depuis 2019)*	 <p>X50</p>	Macrotecture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019

POLYTECH	Microthane	Polyurethane	 <p>X50</p>	Polyurethane	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019
SEBBIN	<p>Exemple</p> <p>LS 50 XXX LS 51 XXX LSC 54 XXX LSC 55 XXX</p>	Lisse	 <p>x200</p>	Lisse	Rapport IEM de 2018	Oui
SEBBIN	<p>Exemple</p> <p>Sublimity®</p> <p>LS 70 XXX LS 71 XXX LSC 72 XXX LSC 73 XXX</p> <p>Integrity®</p>	<p>Microtexturé (avant 2020)</p> <p>Semi-lisse (depuis 2020)*</p>	 <p>x200</p>	Microtexture	Rapport IEM de 2018	Oui

SEBBIN	Volupty® LS 90 XXX LS 91 XXX LSC 92 XXX LSC 93 XXX	Texturé (avant 2020) Microtexturé (depuis 2020)*	 500 µm x50	Macrotexture	Rapport IEM de 2018	Oui
SEBBIN	Exemple LSA-XXX	Macrotexture	 500 µm x50	Macrotexture	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 2 avril 2019
SILIMED	-	Lisse	 X200	Lisse	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 25 septembre 2015

SILIMED	Textured breast implants	Texture	 <p>X50</p>	Macrotextré	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 25 septembre 2015
SILIMED	Polyurethane breast implants	Polyurethane	 <p>X50</p>	Polyurethane	Rapport IEM de 2018	Arrêt de mise sur le marché en France le 25 septembre 2015

* : information transmise par le fabricant suite à reclassification de la texture